

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: info@standart-arms.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛ ГСО
А.В. Мельникова


**Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)**

№ ХО-1416 от 27.04.2015 г.

Всего страниц -1

1 Заявитель: ООО «ИБЕРИУС» (г.Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Первого Мая, дом 33, литер А).

2 Наименование продукции: нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором артикула М311-34.

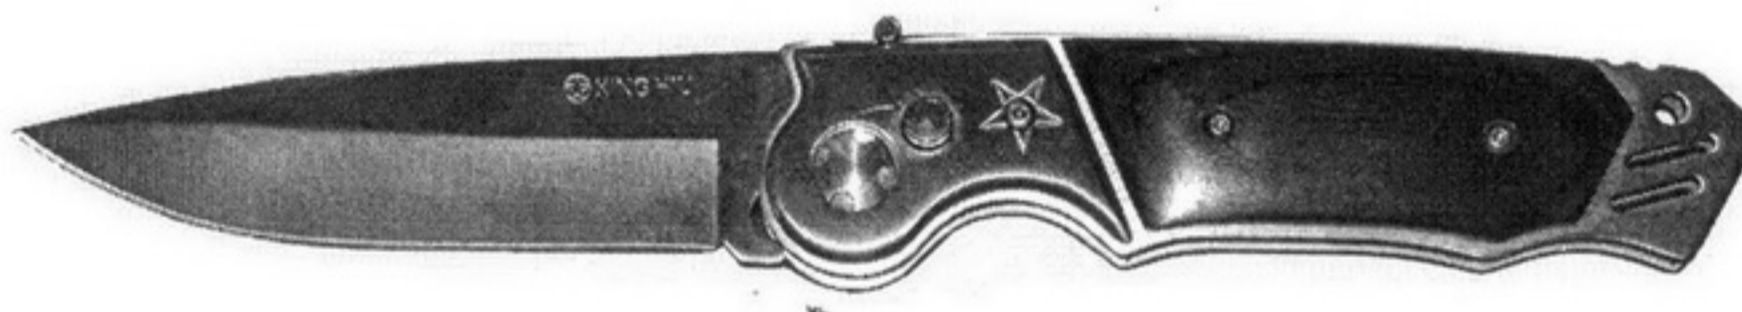

3 Производитель: фирма «МАСТЕР К» (Китай).

4 Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/338 от 20.04.2015 г.

5 Акт отбора образцов: № 143 от 27.04.2015 г.

6 Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентируется	208,0
длина клинка, мм	До 90 (п.4.10)	Соответствует – 87
длина рукояти, мм	Не регламентируется	121,0
толщина обуха, мм	Не регламентируется	2,3
Ширина клинка, мм	Не регламентируется	23,0
толщина рукояти, мм	Не регламентируется	18,0


7 Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- нож складной с автоматическим извлечением клинка и фиксатором артикула М311-34 соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (87-ст) от 18 апреля 2005 г. и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - туристическим ножом, не относящимся к оружию (длина клинка до 90 мм).

Примечание – Ножи артикулов М311-342 и М311-642 являются аналогами ножа арт. М311-34.

Испытатель


подпись

Б.З.Сагдиев
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полное или воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории